



бр. 3-19/2017-4в
07.12.2017. год.

СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-19/2017-2

Предмет: Одговор 3. Комисије за јавну набавку у поступку број 3-19/2017-2 (Образована Решењем број 3-19/2017-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде од 06.12.2017. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 3-19/2017-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре.

Питање:

Zamoliću vas za pojašnjenje vezano za JN 3-19/2017-2 Potrošni laboratorijski materijal za partiju 1:

- Na postavljeno pitanje za stavku br 47 da li se može ponuditi veći otvor za guč bocu od 1000 ml, odgovorili ste da nije moguće. Ne može da se ponudi isti prečnik boce od 1000 i od 500 koji ste tražili u stavci 48. Proizvođači ne proizvode kao takve. S toga vas molimo da uvažite zahtevane dimenzije prečnika 45 mm.
- Na postavljeno pitanje za stavku br 52 za sta treba da se koristi klema za hladnjake, tikvice....odgovorili ste da je odgovarajuće ponudi stalak? Stalak i kleme su različiti artikli. Kako bi ponuda bila odgovarajuća molimo precizirajte sta vam tačno treba? Stativ za birete ili kleme (samo navedite za koju namenu) ili vam treba i stativ i kleme?

Одговор:

Za stavku br 47 - prihvatljivo je ponuditi GUČ bocu 1000ml-otvor 32-38mm ili 29/38.

Za stavku br 52 - prihvatljivo je ponuditi Univerzalnu klemu za tikvice dužine 225mm i raspona 80 do 90mm, sa zaštitnom plutom.

Питање:

Zamoliću vas za pojašnjenje vezano za JN 3-19/2017-2 Potrošni laboratorijski materijal za partiju 1:

- Molimo Vas preciznije odgovorite na pitanje za stavku br 9. Tražite balon sa centralnim i sa bočnim nastavkom. Navedite šlif centralnog, navedite šlif bočnog nastavka. Nije dovoljan samo odgovor centralni šlif a niste naveli koji? A tražite i bocni nastavak? Koji šlif? Ili Vi samo tražite **balon okruglo dno 500 ml sa centralnim šlifom 29/32**.
- Za stavku 62 naveli ste da nije odgovarajuće ponudi levak o25. Da li je prihvatljivo ponuditi levak o35? Ako nije navedite prečnik levka koji je odgovarajući?

Одговор:

Za stavku br 9 - prihvatljivo je ponuditi Balon okruglo dno za destilaciju 500 ml sa bočnim nastavkom gornji otvor (ne mora da bude šlifovan) 4cm i izlazna cev sa strane 20cm.

Za stavku 62 - prihvatljivo je ponuditi Levak za biretu prečnik do o35mm i cev 5mm.

Питање:

Zamoliću vas za pojasnjenje vezano za JN 3-19/2017-2 Potrošni laboratorijski materijal za partiju 1:

- Za stavku br 40 tražite erlenmajer bez šlifa, usko grlo za šlif 29/32 od 500 ml.- U ponudi postoji erlenmajer od 500 sa šlifom 29/32. Ili erlenmajer UG 500 gdje je precnik otvora 34mm. Ne mogu da budu u jednom erlenmajeru bez i sa šlifom. Koji Vam je od ponudjenih odgovarajući?



- Za stavku 45 zahtevate erlenmajer ŠG sa šlifom 25 ml. -
U ponudi postoji Erlenmajer ŠG 25 ml prečnik otvora 31 mm
Ili Erlenmajer 25 sa šlifom od 14/23 ili 19/26 ?
Navedite koji od ponudjenih Vam je prihvatljiv?

Одговор:

Za stavku br 40 - prihvatljivo je ponuditi Erlenmajer bez šlifa, otvor 29/32.
Za stavku br 45 - prihvatljivo je ponuditi Erlenmajer 25ml sa šlifom od 19/26.

Питање:

Poštovani,
Kako su u Vaši odgovori na naša pitanja nepotpuni zahtevamo da nam u potpunosti odgovorite na postavljena pitanja kako bi mogli da damo adekvatnu ponudu a odnosi se na sledeće:
Partija 3, Stavka 61 – Postavljeno pitanje je bilo da nam kažete dužinu optičkog puta i zapreminu, na šta se ste odgovorili da je zapremina 5ml tj.5000ul što uopšte nije standardna zapremina, pa Vas molimo da još jednom proverite zapreminu i koja je dužina optičkog puta na šta nam niste ni prvi put odgovorili?

Одговор:

Za stavku br 61- Kvarcna kiveta za spektrofotometar zapremina 2,5ml-4,5ml (dužina optičkog puta je 10mm).

Питање:

PARTIJA 1

Stavka 51. Shodno odgovoru da je dimenzija kivete 15x15x30 mm, molim neki kat br jer se ne mogu naci kivete za spektrofotometar sa ovim dimenzija. Kako ste naveli podatke u specifikaciji i klasnije u odgovorima, ovo ne moze biti kiveta za spektrofotometar. Za kivete za spektrofotometar je najvazniji podatak za duzinu oprickog puta (da li je 2mm, 5 mm, 10 mm.....) dimenzije i zapremine su slicne kod razlicitih proizvođjaca i uglavnom se ne navode, vec samo dužina optickog puta. Ako je zaista potrebna kiveta za spektrofotometar, molim vas navedite kolika treba da bude dužina optickog puta i to je dovoljan podatak.

Одговор:

Za stavku 51 - prihvatljivo je ponuditi Kivete staklene za spektrofotometar (dužina optickog puta je 10mm).

Питање:

PARTIJA 1

Stavka 52 –Skoro svi proizvođjaci navode samo raspon klema, koji je najbitniji. Zar mora biti bas dimenzija 225 mm? Molim da se taj podatak o dužini izbrise i molim vas navedite za sta treba da bude (hladnjake, tikvice...). U odgovorima ste napisali da je to “univerzalni stalak” – molim odgovor sta treba ponuditi? Ako je potrebna klema, napisite za sta treba da služi i raspon otvora.

Одговор:

Za stavku 52 - prihvatljivo je ponuditi Univerzalnu klemu za tikvice dužine 225mm i raspona 80 do 90mm, sa zaštitnom plutom

Питање:

PARTIJA 1

Stavka 62. Molim da navedete prečnik levka

Одговор:

Za stavku 62 - prihvatljivo je ponuditi Levak za biretu prečnik do 035mm i cev 5mm.



Питање:

PARTIJA 1

Stavka 76. Molim vas da specifikaciju za mufu date podatak za raspon otvora jer nema podataka o ukupnoj duzini kako vi trazite (narocito ovako mala mufa). U katalogima su podaci za duzinu otvora, sto je najbitniji podatak za ovaj artikal. Mozete li izbaciti iz opisa podatke duzinama?

Одговор:

Za stavku 76 - prihvatljivo je ponuditi Muf dužina 70-80mm raspon otvora 25-35mm.

Питање:

PARTIJA 1

Stavka 92. – Graduisane pipete se rade od soda-lime ili AR stakla, molim da se izbacii uslov da su od borsilikatnog stakla

Одговор:

Za stavku 92 – prihvatljivo je ponuditi Graduisane pipete od AR stakla.

Питање:

Molimo za odgovore za partiju 3:

Za stavku 46 – cep gumeni 21/27, da li je u pitanju konusni cep 21mm x 27mm visine 30mm?

Za stavku 47 – cep gumeni 23/29, u skladu sa vasim odgovorima zakljucujemo da je u pitanju cep top 24mm, bottom 18mm I visine 30mm, da li je u pitanju konusni cep prema navedenim dimenzijama?

Za stavku 139 – da li je odgovarajuca staklena posuda Hellendahl?


Одговор:

Za stavku 46 – da, u pitanju konusni cep 21mm x 27mm visine 30mm.

Za stavku 47 – da, u pitanju je konusni cep top 24mm, bottom 18mm I visine 30mm.

Za stavku 139 – da, prihvatljivo je ponuditi Staklenu posudu Hellendahl.

Наручилац ће извршити измене и објавити пречишћен текст Обрасца структуре цене.

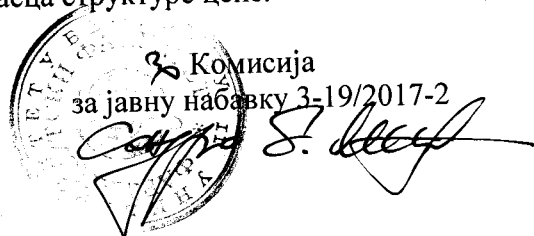

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.